




# sobres para la esterilización CE dim.150x300 mm tipo estándar

sobres para la esterilización CE dim.150x300 mm estándar tipo-Cf.1000pc

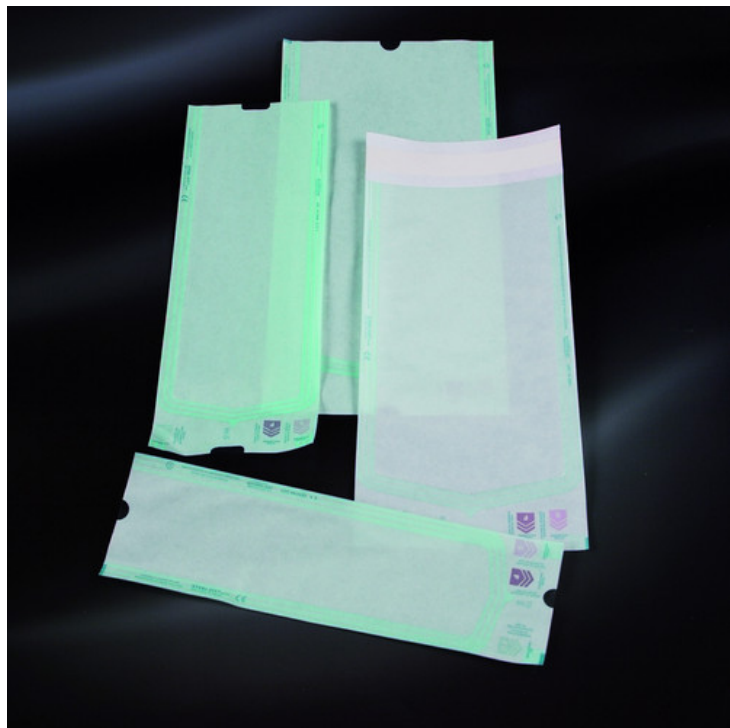

## Product codes:

Reference: 64 846 0021

## Product gallery:

## Product description:

Plana bolsas desechables para esterilizar instrumentos quirúrgicos u otros Dispositivos Médicos por óxido de etileno o de Vapor. Son producidos en grado médico de papel junto con una película plástica transparente. En cada uno de los sobres se imprimen, toda la información necesaria para asegurar la identificación y la trazabilidad. Ellos también están impresos los indicadores adecuados para la esterilización con etileno y óxido de Vapor; el cambio de color indica que el Dispositivo ha sido sometido al proceso de esterilización. También disponible en la auto-sellado con cinta de doble cara que permite el cierre de los sobres, incluso en la ausencia de sellado de la máquina. En cumplimiento con la norma UNI EN ISO 11607:1-2 ISO 11140-1 y UNI EN 868-5 clasificados como Dispositivos Médicos de Clase I no estéril 93/42/CE



---

### Product features:

BST - CUMPLIMIENTO: UNI EN ISO 11607  
BST - CUMPLIMIENTO: ISO 11140-1  
BST - CUMPLIMIENTO: UNI EN 868-5  
BST - CUMPLIMIENTO: dispositivo medico I classe  
BST - CAPACIDAD: nd  
BST - TIPO DE: la esterilización  
BST - CIERRE: sin mecanismos de  
BST - FILTRO: sin  
BST - DIMENSIONES: 150x300mm  
BST - DE ESPESOR: 83+52um  
BST - MATERIAL: carta/plastica  
BST - ESTÉRIL: no  
BST - CON SÍMBOLOS: biohazard  
BST - CON BOLSILLO: no  
BST - ÁREA DE ESCRITURA: no  
BST - AUTO DE PIE: no  
BST - CODIFICACIÓN DE COLOR: no  
BST - CARACTERÍSTICAS: los sobres, la esterilización de papel/plástico para la esterilización de dispositivos médicos dim.150x300mm  
BST - COMPATIBLE: EtO  
BST - COMPATIBLE: vapore  
BST - APROPIADO PARA: la esterilización  
BST - RESISTENCIA: las altas temperaturas  
BST - RESISTENCIA: la esterilización  
BST - COMPLETO: indicatore  
BST - COMPLETO: datos de trazabilidad