




sobres para la esterilización CE dim.300x500 mm tipo estándar

sobres para la esterilización CE dim.300x500 mm estándar tipo-Cf.500pcs

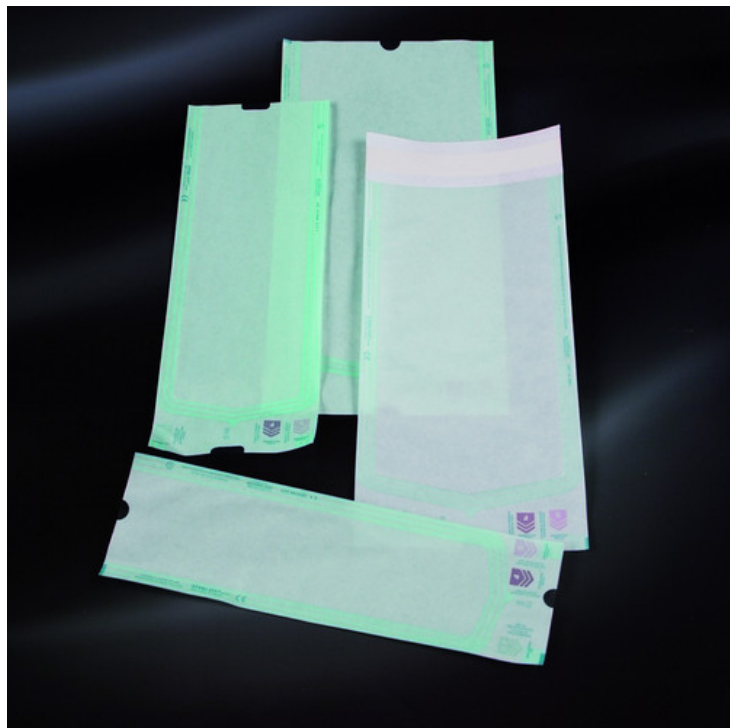

Product codes:

Reference: 64 846 0031

Product gallery:

Product description:

Plana bolsas desechables para esterilizar instrumentos quirúrgicos u otros Dispositivos Médicos por óxido de etileno o de Vapor. Son producidos en grado médico de papel junto con una película plástica transparente. En cada uno de los sobres se imprimen, toda la información necesaria para asegurar la identificación y la trazabilidad. Ellos también están impresos los indicadores adecuados para la esterilización con etileno y óxido de Vapor; el cambio de color indica que el Dispositivo ha sido sometido al proceso de esterilización. También disponible en la auto-sellado con cinta de doble cara que permite el cierre de los sobres, incluso en la ausencia de sellado de la máquina. En cumplimiento con la norma UNI EN ISO 11607:1-2 ISO 11140-1 y UNI EN 868-5 clasificados como Dispositivos Médicos de Clase I no estéril 93/42/CE



Product features:

BST - CUMPLIMIENTO: UNI EN ISO 11607
BST - CUMPLIMIENTO: ISO 11140-1
BST - CUMPLIMIENTO: UNI EN 868-5
BST - CUMPLIMIENTO: dispositivo medico I classe
BST - CAPACIDAD: nd
BST - TIPO DE: la esterilización
BST - CIERRE: sin mecanismos de
BST - FILTRO: sin
BST - DIMENSIONES: 300x500mm
BST - DE ESPESOR: 83+52um
BST - MATERIAL: carta/plastica
BST - ESTÉRIL: no
BST - CON SÍMBOLOS: biohazard
BST - CON BOLSILLO: no
BST - ÁREA DE ESCRITURA: no
BST - AUTO DE PIE: no
BST - CODIFICACIÓN DE COLOR: no
BST - CARACTERÍSTICAS: los sobres, la esterilización de papel/plástico para la esterilización de dispositivos médicos dim.300x500mm
BST - COMPATIBLE: EtO
BST - COMPATIBLE: vapore
BST - APROPIADO PARA: la esterilización
BST - RESISTENCIA: las altas temperaturas
BST - RESISTENCIA: la esterilización
BST - COMPLETO: indicatore
BST - COMPLETO: datos de trazabilidad